

Số: 181 /TMBG-BVĐKPY

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 06 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Huỳnh Thị Hoa Lại, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.
(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo thư mời báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa Phú Yên)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 - Đến trước 17h ngày 12 tháng 06 năm 2026⁽²⁾
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
 - Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.


Số TT	Danh mục hàng hoá	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng
01	Máy thở di động	I. Yêu cầu chung: <ul style="list-style-type: none">- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau.- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.- Nguồn điện sử dụng: AC 220V–240V, 50/60Hz.- Có pin tích hợp sử dụng tối thiểu 4 giờ liên tục.- Phù hợp sử dụng trong vận chuyển nội viện, cấp cứu và hồi sức.- Máy chính có xuất xứ từ một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU). II. Cấu hình thiết bị cơ bản: <ul style="list-style-type: none">- Máy thở di động chính: 01 máy- Xe đẩy đồng bộ có khóa bánh: 01 bộ- Giá treo bình Ô xy: 01 bộ- Tay đỡ dây thở: 01 bộ	Máy	01

	<p>- Bộ dây thở sử dụng nhiều lần cho người lớn: 01 bộ - Bộ dây thở sử dụng nhiều lần cho trẻ em/trẻ sơ sinh: 01 bộ - Pin/ắc quy tích hợp bên trong máy: 01 cái - Cảm biến Oxy: 01 cái - Cảm biến lưu lượng: 01 cái - Bộ lọc vi khuẩn/virus phù hợp hệ thống: 01 cái - Mặt nạ thở sử dụng người lớn: 01 cái - Mặt nạ thở sử dụng trẻ em: 01 cái - Phôi giả người lớn: 01 cái - Phôi giả trẻ em: 01 cái - Dây nguồn và phụ kiện chuẩn đi kèm: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh: 01 bộ</p> <p>III. Thông số kỹ thuật:</p> <p>1. Chế độ thở tối thiểu: VCV; PCV; SIMV; PSV/CPAP; Manual breath. (Máy có khả năng thở xâm nhập và không xâm nhập cho bệnh nhân người lớn và trẻ em.) 2. Đối tượng bệnh nhân: Người lớn và trẻ em. 3. Màn hình hiển thị: Màn hình màu LCD/TFT tối thiểu 5 inch; hiển thị dạng sóng áp lực/lưu lượng, thể tích khí lưu thông, tần số thở, FiO₂, PEEP, áp lực đường thở. 4. Cài đặt thông số: VT; Tần số thở; FiO₂; PEEP; Áp lực hít vào. 5. Báo động an toàn: Áp lực cao/thấp; Mất nguồn điện; Pin yếu; Ngưng thở; Thể tích khí thấp; Mất nguồn khí. 6. Nguồn khí: Phải sử dụng được khí oxy từ hệ thống khí trung tâm của bệnh viện và từ bình oxy;</p> <p>IV. Yêu cầu khác</p> <p>- Có khả năng hoạt động ổn định khi vận chuyển bệnh nhân. - Nhà cung cấp cam kết bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p>		
--	--	--	--

Lưu ý: - Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá đã bao gồm thuế, chi phí hàng hóa, vận chuyển và các chi phí khác nếu có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GĐBV (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia;
- Lưu: VT; phòng VT-TBYT.

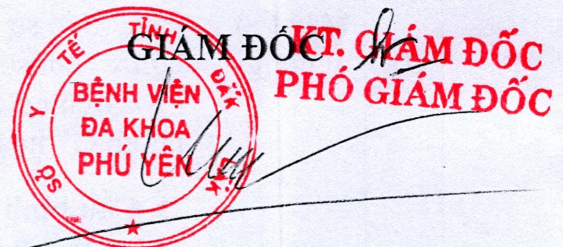

Bùi Anh Hòa